

Dieses Schulungsmaterial wurde als risikominimierende Maßnahme beauftragt und mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) abgestimmt. Es soll sicherstellen, dass Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen von Romiplostim kennen und berücksichtigen.

Dieser Leitfaden ist Bestandteil des **Informationsmaterials für Patientinnen und Patienten** für die Selbstinjektion von Nplate.

LEITFADEN FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG – PATIENTINNEN UND PATIENTEN

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG FÜR DIE VORBEREITUNG UND ANWENDUNG DER NPLATE-INJEKTION



Nplate (Romiplostim)

Bitte lesen Sie auch die Gebrauchsinformation (Packungsbeilage) von Nplate aufmerksam durch.

Eine bebilderte Anleitung für die Anwendung von Nplate zu Hause

Diese Broschüre begleitet Sie bei allen Schritten, die Sie durchführen müssen, um Ihre wöchentliche Nplate-Injektion erfolgreich zu Hause vorzubereiten und anzuwenden.

Im Verlauf Ihrer Schulung hat Ihnen Ihr Arzt bereits alle in dieser *Schritt-für-Schritt-Anleitung* beschriebenen Schritte gezeigt. Bei der Anwendung zu Hause erinnert Sie diese Broschüre an jeden einzelnen Schritt der Vorbereitung und Anwendung, so dass Sie sicher sein können, jeden Schritt fehlerfrei durchzuführen.

BITTE WENDEN SIE SICH MIT ALLEN IHREN FRAGEN UND ANLIEGEN AN IHREN ARZT.

BEVOR SIE BEGINNEN

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

Die Hinweise in dieser *Schritt-für-Schritt-Anleitung* wenden sich an Patienten, die bereits durch ihren Arzt oder medizinisches Fachpersonal in der Selbstinjektion geschult wurden. Wenn Sie keine Schulung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und wenden Sie Nplate nicht selbst an.

Ein paar Hinweise zur Lagerung und zum Gebrauch

Bewahren Sie Nplate bis unmittelbar vor dem Gebrauch in der Originalverpackung im Kühlschrank auf.

- Nplate darf nicht eingefroren werden.
- Nplate muss vor Licht geschützt aufbewahrt werden.
- Nplate muss kühl gelagert werden (im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C), darf aber nicht eingefroren werden. Nplate kann für einen Zeitraum von 30 Tagen aus dem Kühlschrank entnommen und bei Raumtemperatur (nicht über 25 °C) aufbewahrt werden.
- Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Etikett der Durchstechflasche nach „verwendbar bis“ bzw. „EXP“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Injizieren Sie Nplate unmittelbar nachdem es aufgelöst ist.

Möglicherweise bleibt überschüssiges Nplate nach der Anwendung der verschriebenen Dosis übrig. Wenden Sie Nplate nicht erneut an! Überschüssiges gelöstes Nplate muss sofort nach Abschluss der Injektion verworfen werden. Restliches Nplate darf NIEMALS für eine weitere Injektion wiederverwendet werden.

SCHRITT 1: LEGEN SIE DIE GEGENSTÄNDE FÜR EINE INJEKTION BEREIT

Bereiten Sie zuerst Ihre Arbeitsfläche und die *Nplate Arbeitsunterlage* vor:

Legen Sie die *Arbeitsunterlage* auf eine saubere, gut beleuchtete, ebene Oberfläche (z. B. einen Tisch).

Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch gründlich ab.

Reinigen Sie die *Arbeitsunterlage* mit einem Alkoholtupfer (Gegenstand F).



SCHRITT 1: LEGEN SIE DIE GEGENSTÄNDE FÜR EINE INJEKTION BEREIT


Nachdem Sie sich eine saubere und gebrauchsbereite Arbeitsfläche vorbereitet haben, nehmen Sie das Nplate-Kit zur Selbstinjektion aus dem Kühlschrank.

Werfen Sie einen genauen Blick auf das Pulver, um zu prüfen, ob es gefroren ist. **Verwenden Sie es nicht, wenn es gefroren ist.** Wenn Sie Fragen zur Aufbewahrung haben, wenden Sie sich für weitere Anweisungen an das medizinische Fachpersonal.

Überprüfen Sie das Verfalldatum auf dem Kit zur Selbstinjektion. Verwenden Sie dieses nicht, wenn das Verfalldatum abgelaufen ist. Stellen Sie die Vorbereitung ein und kontaktieren Sie Ihr medizinisches Fachpersonal.

HINWEIS: Wenn Ihr Arzt Sie darauf hingewiesen hat, dass für Ihre Nplate-Dosis mehr als eine Nplate-Injektion erforderlich ist, benötigen Sie mehr als ein Kit zur Selbstinjektion. Befolgen Sie die Schritte, wie in dieser *Schritt-für-Schritt-Anleitung* beschrieben, und benutzen Sie so viele Kits zur Selbstinjektion wie erforderlich, um Ihre verschriebene Nplate-Dosis zu erreichen.


Stellen Sie sicher, dass die unten aufgeführten Gegenstände bereitliegen. Sie benötigen diese für die Vorbereitung und Anwendung von Nplate. Die Gegenstände sind in der gleichen Weise angeordnet wie auf Ihrer *Nplate Arbeitsunterlage*, die Sie bei der Vorbereitung Ihrer Nplate-Injektion immer verwenden sollten. HINWEIS: Öffnen Sie die Gegenstände nicht, bevor Sie in dieser Anleitung dazu aufgefordert werden. Benutzen Sie keines der Einzelteile bei Hinweisen auf Fälschung oder Beschädigung. Verwenden Sie keinen der Gegenstände mehrfach. Der durchstichsichere Behälter ist in Ihrem Selbstinjektionspaket nicht enthalten und sollte besorgt werden, bevor mit der Selbstinjektion begonnen wird.

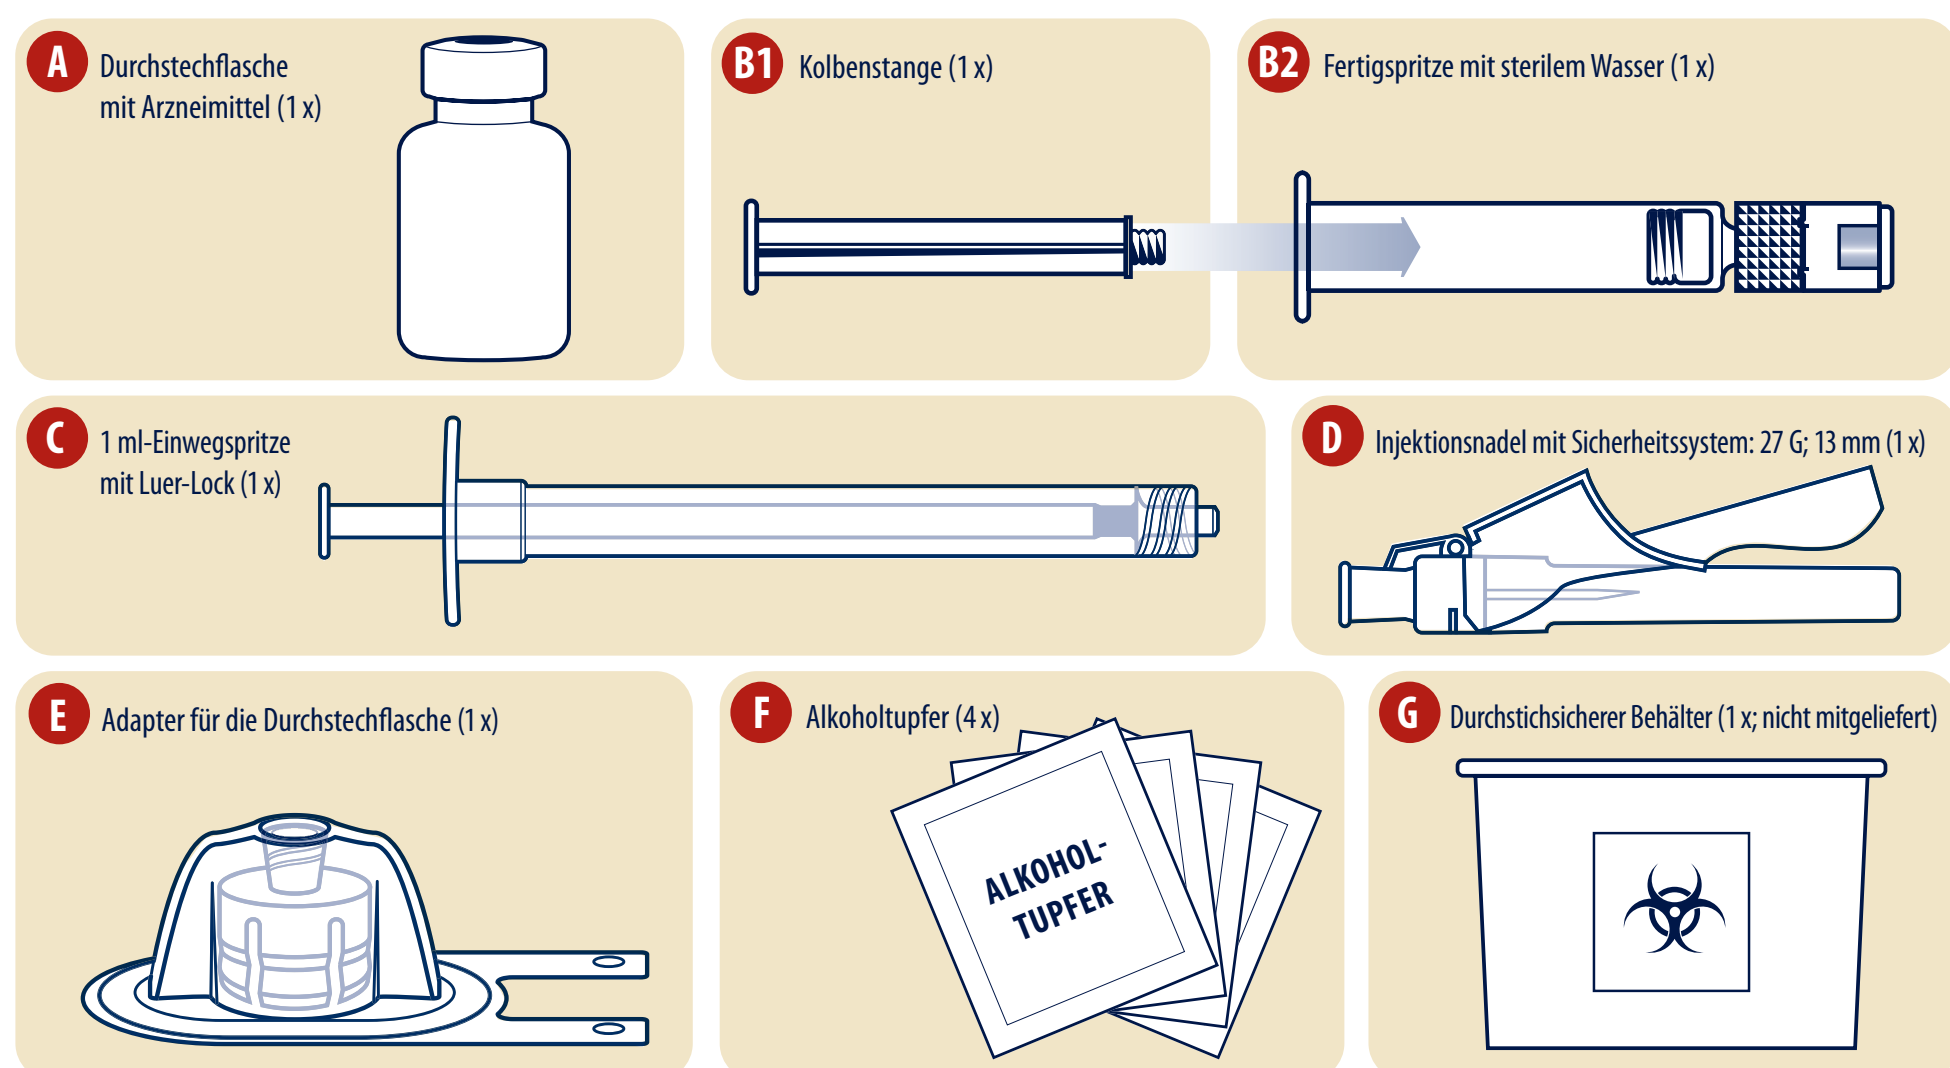

SCHRITT 2: BEREITEN SIE DIE DURCHSTECHFLASCHE FÜR DIE ANWENDUNG VOR, BRINGEN SIE DEN ADAPTER FÜR DIE DURCHSTECHFLASCHE AN

Für diesen Schritt benötigen Sie 1 Alkoholtupfer (Gegenstand F), 1 Nplate-Durchstechflasche (Gegenstand A) und 1 Adapter für die Durchstechflasche (Gegenstand E).


- Entfernen Sie den roten (250 Mikrogramm) oder blauen (500 Mikrogramm) Plastikschnappdeckel von der Durchstechflasche.

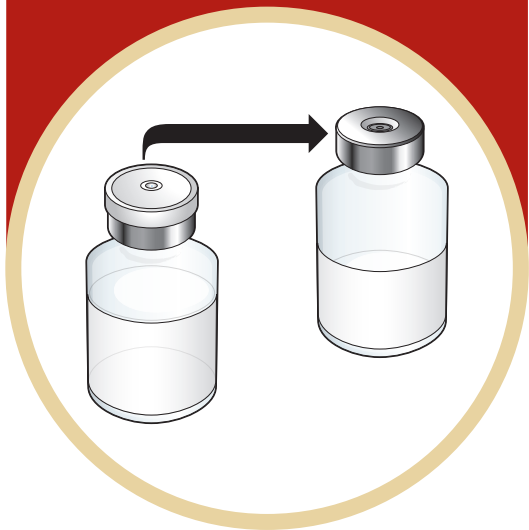


- Reinigen Sie den Stopfen der Durchstechflasche mit einem neuen Alkoholtupfer.
- Berühren Sie den Stopfen nach der Reinigung nicht mehr.



- Ziehen Sie die Papierabdeckung langsam vom Adapter für die Durchstechflasche. Belassen Sie dabei den Adapter für die Durchstechflasche in der Plastikverpackung.
- Berühren Sie nicht den Stopfen der Durchstechflasche oder den Dorn des Adapters für die Durchstechflasche.

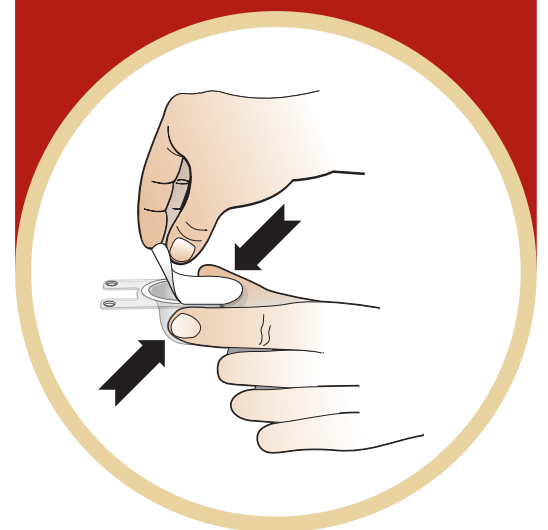

- Stellen Sie die Durchstechflasche auf den Tisch und positionieren Sie den Dorn des Adapters für die Durchstechflasche mittig auf dem Stopfen in der Durchstechflasche. Belassen Sie dabei den Adapter für die Durchstechflasche in der Plastikverpackung.
- Drücken Sie den Adapter für die Durchstechflasche so lange auf die Durchstechflasche, bis er fest sitzt und Sie ihn nicht weiter herunterdrücken können.

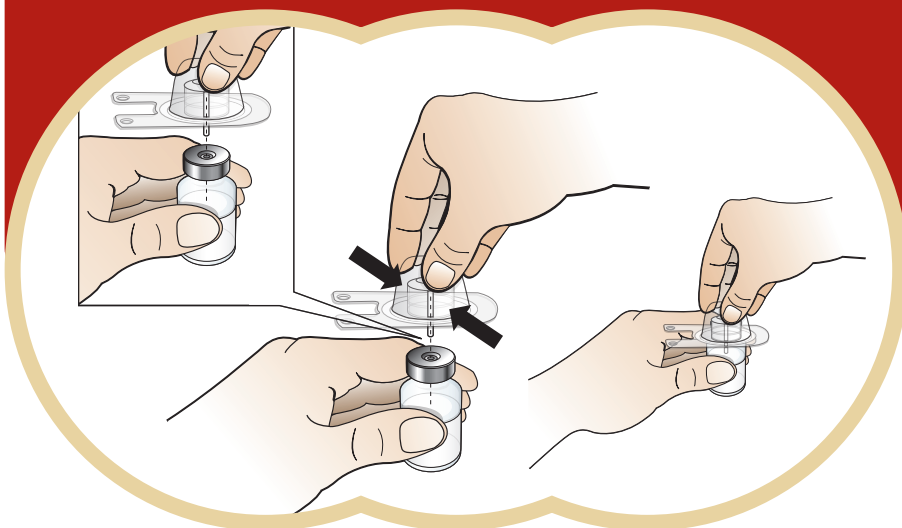

- Heben Sie die Verpackung des Adapters für die Durchstechflasche ab. Belassen Sie dabei den Adapter für die Durchstechflasche auf der Durchstechflasche.
- Berühren Sie nicht das obere Ende des Adapters für die Durchstechflasche.




SCHRITT 3: BEREITEN SIE DIE SPRITZE MIT STERILEM WASSER VOR


Für diesen Schritt benötigen Sie 1 Kolbenstange (Gegenstand B1) und 1 Fertigspritze mit Wasser (Gegenstand B2).

Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie mit Schritt 3 beginnen: Die durchsichtige Plastikkolbenstange MUSS immer zuerst befestigt werden, bevor die weiße Spitze der Fertigspritze mit Wasser abgebrochen wird. Führen Sie Schritt 3a vor Schritt 3b durch.

- **Schritt 3a:** Befestigen Sie die durchsichtige Plastikkolbenstange an der Fertigspritze mit sterilem Wasser, indem Sie das Ende der Kolbenstange mit dem Gewinde in die Spritze stecken und die Stange vorsichtig im Uhrzeigersinn auf den grauen Kolben der Spritze drehen, bis Sie einen leichten Widerstand spüren. Ziehen Sie nicht zu fest an.

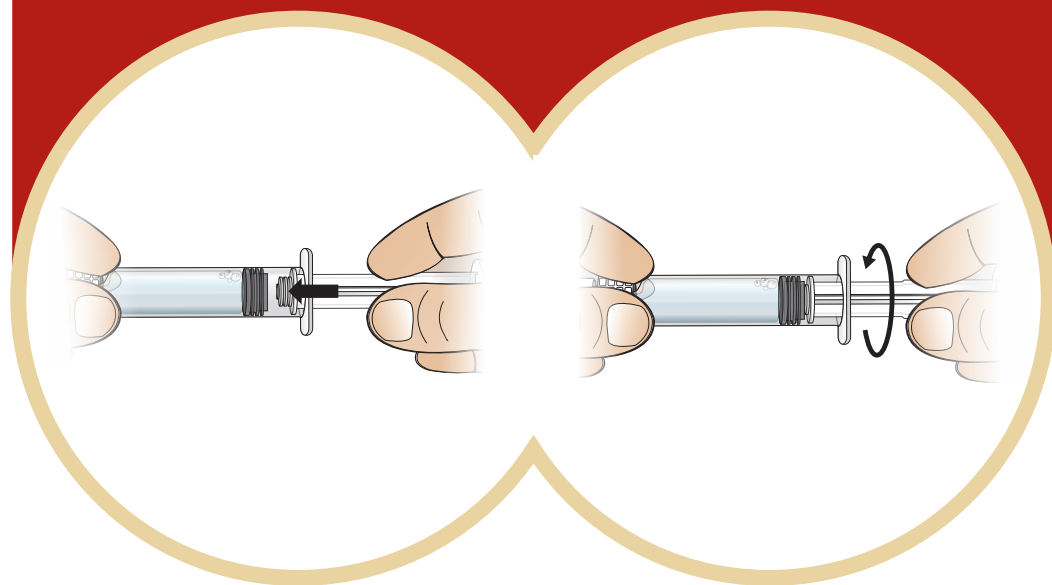

- **Schritt 3b:** Halten Sie die Spritze mit der einen Hand, während Sie die Spitze der weißen Plastikabdeckung mit der anderen Hand nach unten biegen. Damit wird das Siegel der weißen Plastikabdeckung aufgebrochen.
- Sobald das Siegel aufgebrochen ist, ziehen Sie die weiße Plastikabdeckung ab. Sie werden grauen Gummi in der Plastikabdeckung erkennen.

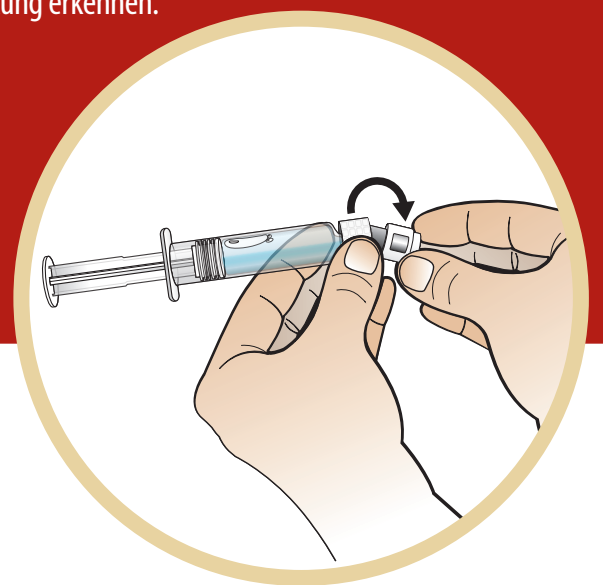


SCHRITT 4: LÖSEN SIE NPLATE DURCH INJEKTION VON WASSER IN DIE DURCHSTECHFLASCHE AUF

Für diesen Schritt benötigen Sie die soeben in Schritt 3 zusammengesetzte Spritze sowie die Durchstechflasche mit Adapter aus Schritt 2.

Bitte beachten Sie Folgendes, bevor Sie mit Schritt 4 beginnen: Nplate-Pulver vorsichtig und langsam auflösen. Dies ist ein Produkt aus Protein, und Proteine können leicht durch unsachgemäßes Mischen und zu starkes Schütteln beschädigt werden.


- Während Sie die Durchstechflasche auf dem Tisch belassen, befestigen Sie die mit Wasser gefüllte Spritze am Adapter für die Durchstechflasche, indem Sie die Durchstechflasche seitlich mit einer Hand festhalten und die Spitze der Spritze mit der anderen Hand im Uhrzeigersinn auf den Adapter drehen, bis Sie einen leichten Widerstand spüren.

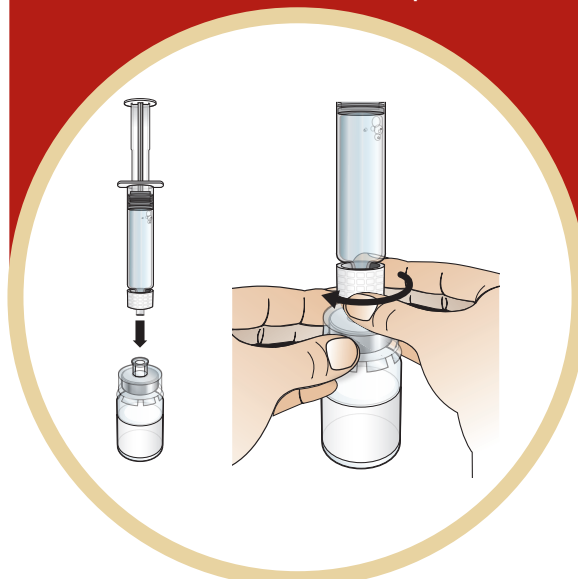

SCHRITT 4: LÖSEN SIE NPLATE DURCH INJEKTION VON WASSER IN DIE DURCHSTECHFLASCHE AUF


- Drücken Sie die Kolbenstange sehr langsam und behutsam nach unten, um das gesamte Wasser von der Spritze in die Durchstechflasche zu injizieren. Das Wasser muss langsam auf das Pulver fließen.
- Drücken Sie das Wasser **nicht** mit zu viel Kraft in die Durchstechflasche.

HINWEIS: Es ist normal, dass sich die Kolbenstange nach der Injektion des Wassers in die Durchstechflasche wieder nach oben bewegt. Sie müssen keinen dauerhaften Druck auf den Kolben ausüben, während Sie Schritt 4 beenden.

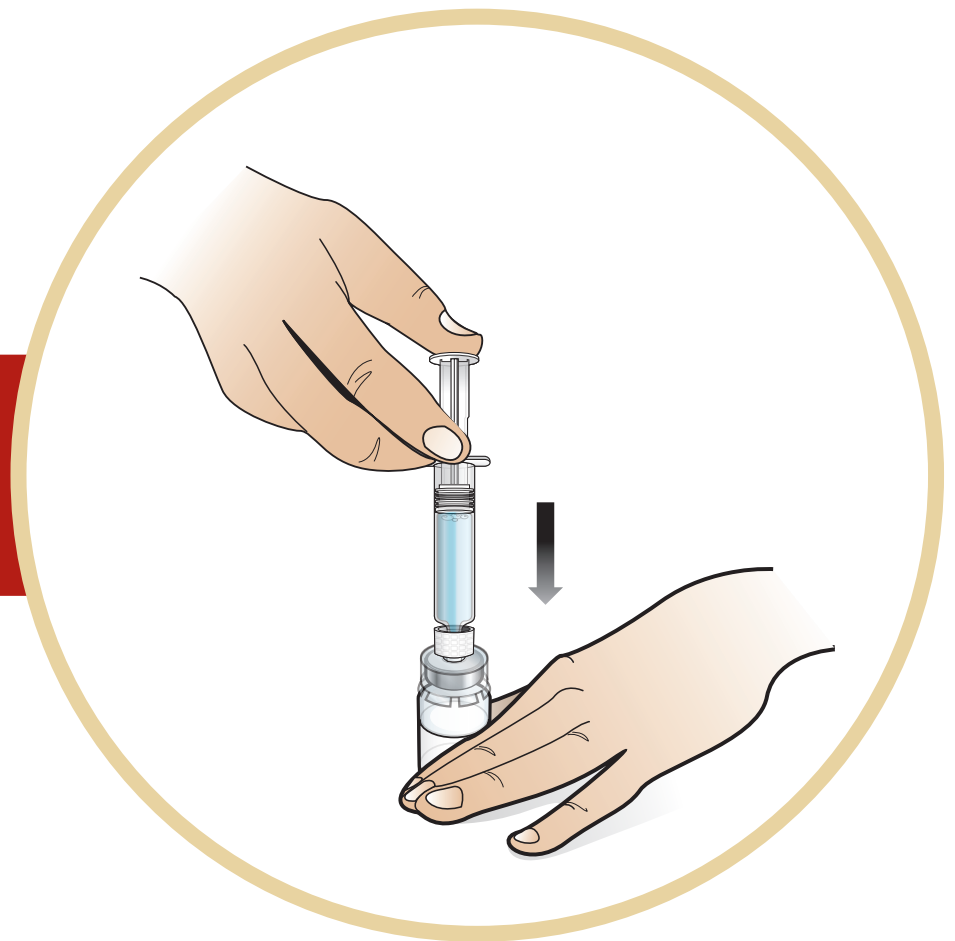


Bevor Sie fortfahren:
Stellen Sie vor dem
Auflösen sicher, dass
das gesamte Wasser
aus der Spritze in die
Durchstechflasche
injiziert wurde.

Richtig

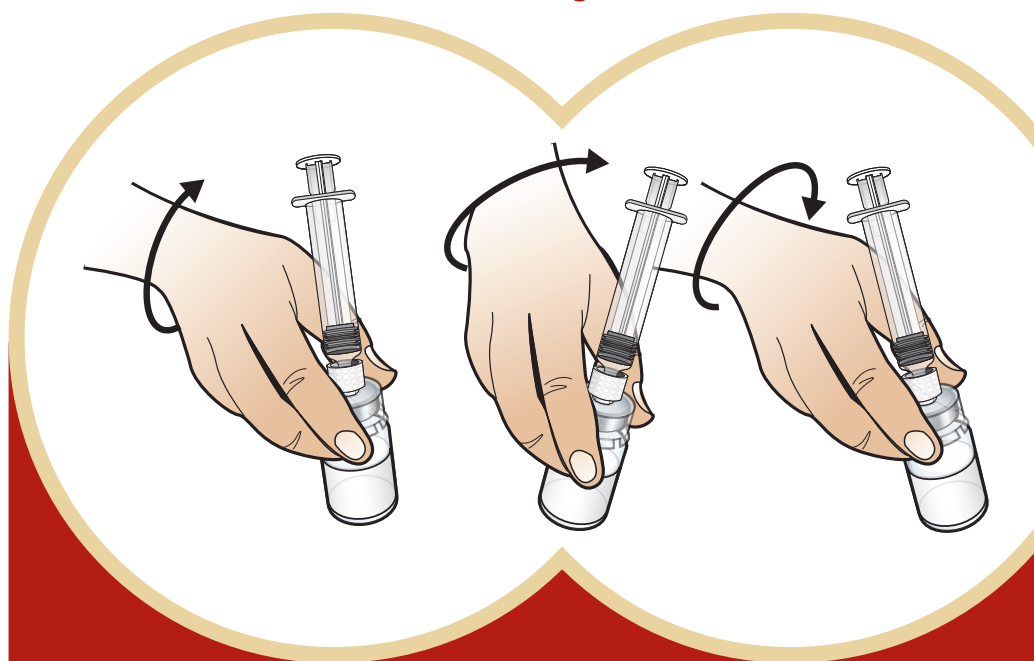

- Halten Sie die Verbindungsstelle zwischen der Durchstechflasche und dem Adapter für die Durchstechflasche mit den Fingern fest und schwenken Sie die Durchstechflasche behutsam, indem Sie Ihr Handgelenk schwenken, bis das gesamte Pulver aufgelöst und die Lösung in der Durchstechflasche klar und farblos ist.

Falsch

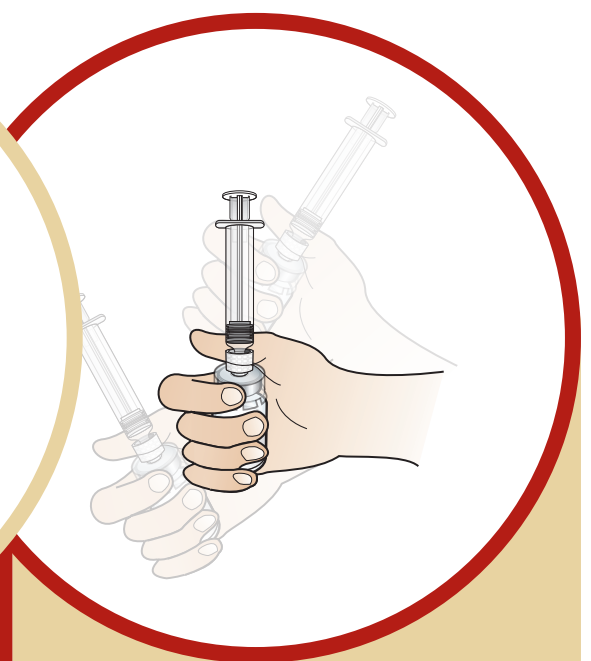


- **Schütteln** Sie die Durchstechflasche **nicht**.
- **Rollen** Sie die Durchstechflasche **nicht** zwischen den Handflächen.

HINWEIS: Es kann bis zu 2 Minuten dauern, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.

SCHRITT 4: LÖSEN SIE NPLATE DURCH INJEKTION VON WASSER IN DIE DURCHSTECHFLASCHE AUF

- Bevor Sie fortfahren:
- Prüfen Sie die gelöste Flüssigkeit optisch auf Partikel und/oder Verfärbungen. Sie muss klar, farblos und vollständig aufgelöst sein.
- Hinweis: Kontaktieren Sie das medizinische Fachpersonal, sollten Verfärbungen oder Partikel in der Flüssigkeit erkennbar sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit vollständig gelöst ist, bevor Sie die Spritze entfernen.
- Sobald Nplate vollständig gelöst ist, entfernen Sie die leere Spritze, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn vom Adapter für die Durchstechflasche drehen.

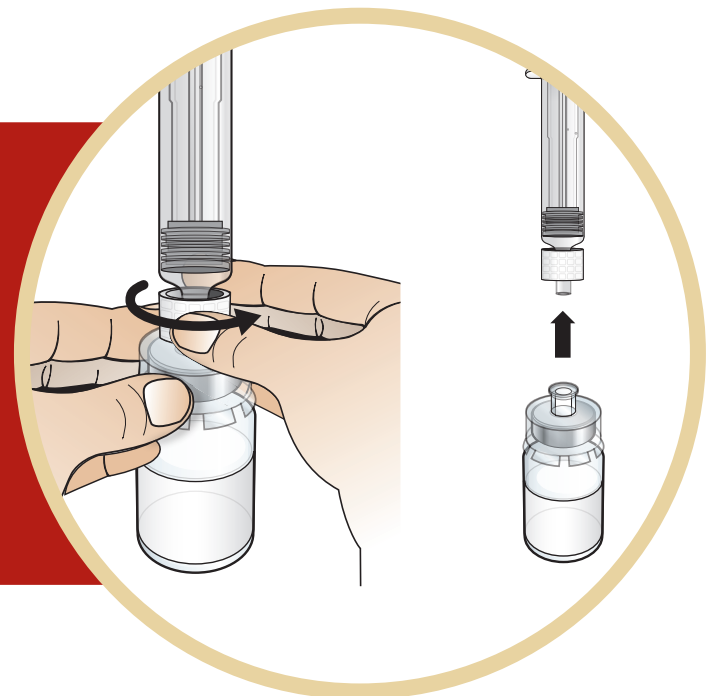

- Entsorgen Sie die leere Spritze in einem Sicherheitsbehälter für scharfe oder gefährliche Gegenstände. Bewahren Sie die Durchstechflasche mit gelöstem Nplate auf. Bereiten Sie unverzüglich eine neue Spritze für die Injektion vor.
- Verzögern Sie die Injektion von Nplate nicht.




SCHRITT 5: BEREITEN SIE EINE NEUE SPRITZE FÜR DIE INJEKTION VOR


Für diesen Schritt benötigen Sie die Durchstechflasche mit klarem, gelöstem Nplate mit dem Adapter für die Durchstechflasche aus Schritt 4 sowie die 1 ml-Spritze (Gegenstand C).

Bevor Sie fortfahren: Überprüfen Sie Ihre Dosis, bevor Sie mit dem nächsten Schritt beginnen. Hinweis: Da die Nplate-Flüssigkeit hochwirksam ist, sind Genauigkeit und Dosisbestimmung wichtig. Stellen Sie sicher, dass alle Luftblasen vor der Injektion entfernt werden.


- Entnehmen Sie die 1 ml-Spritze aus der Verpackung.
- Ziehen Sie bis zur 1 ml-Markierung Luft in die Spritze.
- Ziehen Sie die Kolbenstange nicht über 1 ml hinaus.

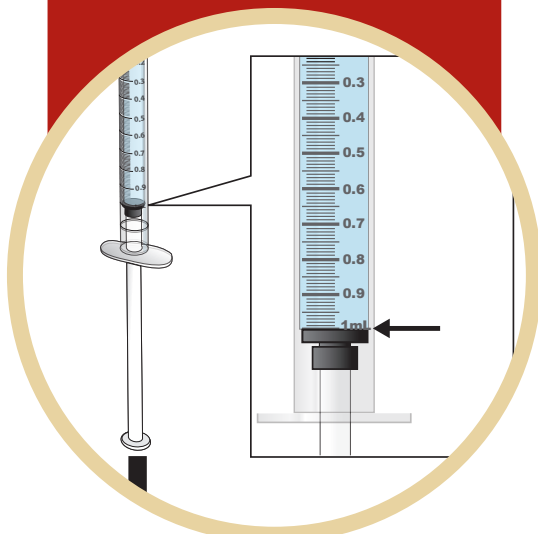

- Befestigen Sie die 1 ml-Spritze an dem Adapter für die Durchstechflasche mit gelöstem Nplate, indem Sie die Spitze der Spritze im Uhrzeigersinn auf den Adapter der Durchstechflasche drehen, bis Sie einen leichten Widerstand spüren.

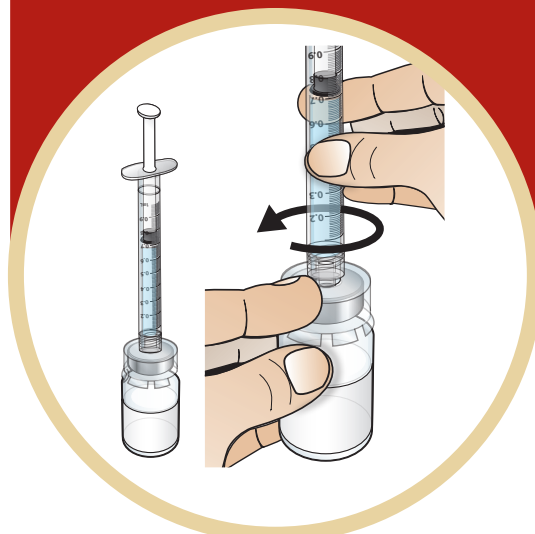


- A. Drücken Sie die Luft in die Durchstechflasche.
- B. Üben Sie weiter Druck auf die Kolbenstange aus.
- C. Drehen Sie die Einheit aus Durchstechflasche und Spritze um, so dass sich die Durchstechflasche direkt über der Spritze befindet.

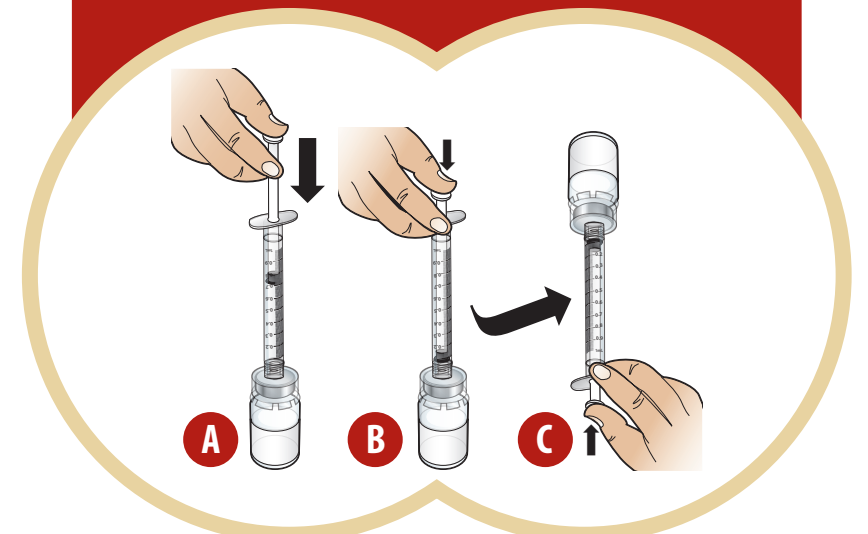


SCHRITT 5: BEREITEN SIE EINE NEUE SPRITZE FÜR DIE INJEKTION VOR


- Ziehen Sie die komplette Menge der Flüssigkeit in die Spritze auf.
- Das maximal entnehmbare Volumen beträgt 0,5 ml bei der 250 Mikrogramm-Durchstechflasche und 1 ml bei der 500 Mikrogramm-Durchstechflasche.
- Ziehen Sie die Kolbenstange nicht aus der Spritze heraus.

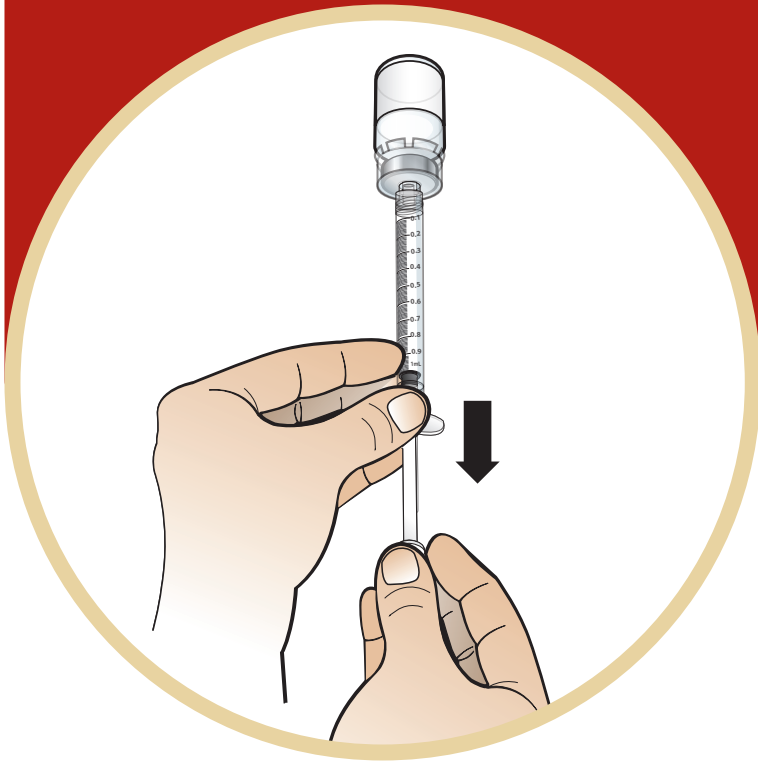


- Stellen Sie sicher, dass die Kolbenstange in der Spritze verbleibt.

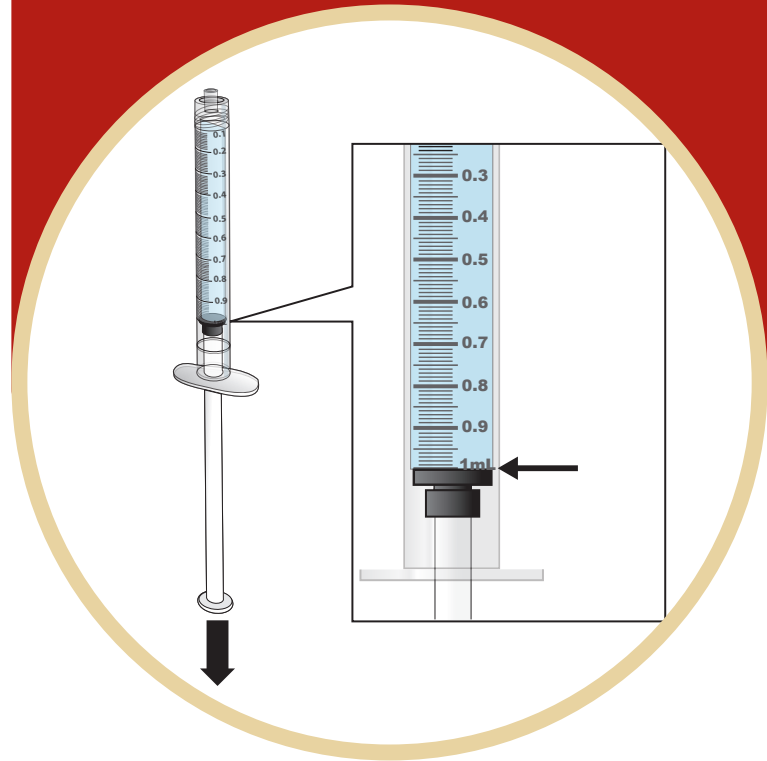


- Überprüfen und entfernen Sie alle Luftblasen aus der Spritze.
- Klopfen Sie vorsichtig mit den Fingern gegen die Spritze, um die Luftblasen von der Flüssigkeit zu trennen.
- Drücken Sie die Kolbenstange langsam hoch, um die Luftblasen aus der Spritze zu drücken.

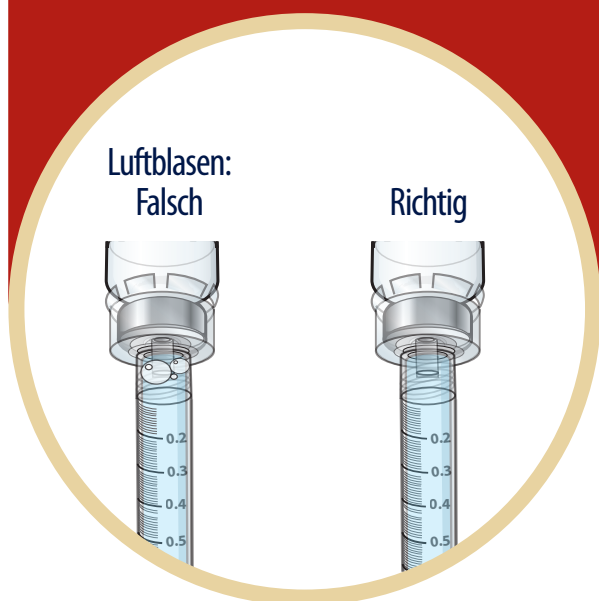

- **Überprüfen Sie Ihre Dosis anhand Ihrer Dosiskarte.**
- Bewegen Sie die Kolbenstange langsam, um nur die Menge zu behalten, die von Ihrem Arzt verschrieben wurde.

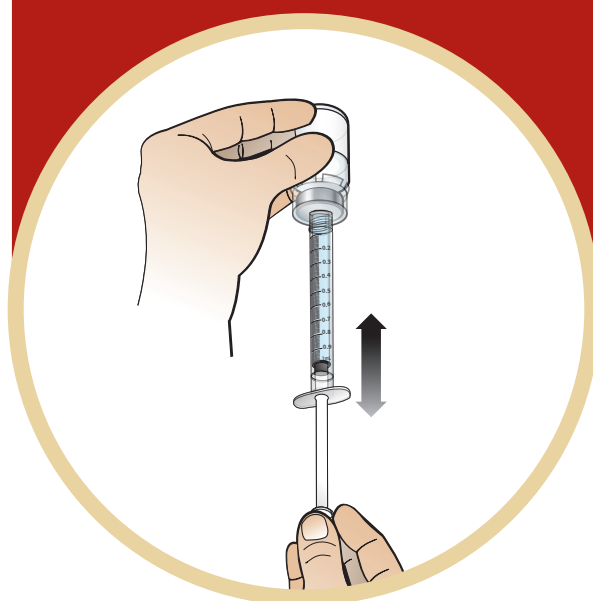


- Stellen Sie sicher, dass das obere Ende der Kolbenstange mit der Spritzenmarkierung übereinstimmt, die Ihrer verschriebenen Dosis entspricht. Falls nötig, drücken Sie Flüssigkeit zurück in die Durchstechflasche, um Ihre gewünschte Dosis zu erhalten.
- Überprüfen Sie ein letztes Mal, dass die Ihrer Dosis entsprechende richtige Menge an Flüssigkeit in der Spritze ist und alle Luftblasen entfernt worden sind.

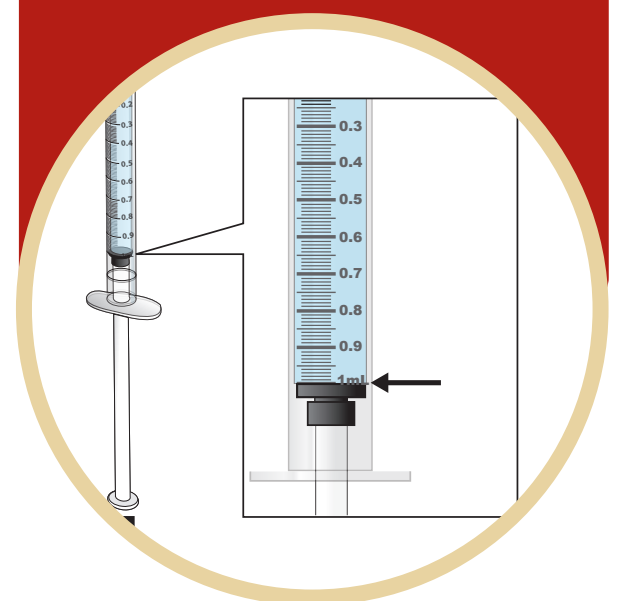

Bevor Sie fortfahren: Stellen Sie sicher, dass die Ihrer Dosis entsprechende richtige Menge an Flüssigkeit in der Spritze verbleibt. Stellen Sie sicher, dass alle Luftblasen aus der Spritze entfernt wurden.

SCHRITT 5: BEREITEN SIE EINE NEUE SPRITZE FÜR DIE INJEKTION VOR

- Sobald alle Luftblasen entfernt und die Spritze mit der richtigen Dosis gefüllt ist, drehen Sie die Spritze vom Adapter für die Durchstechflasche ab.

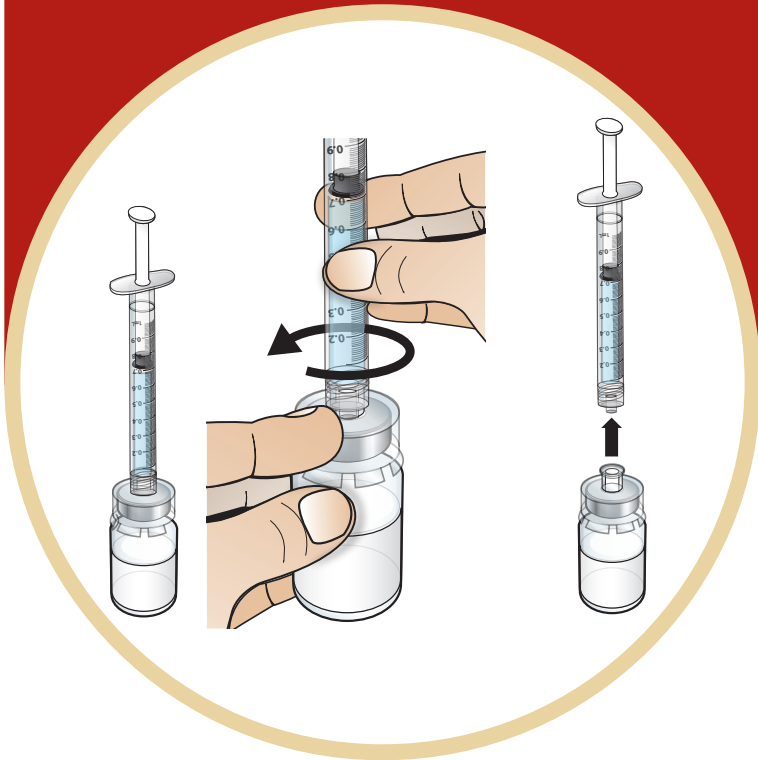


- Behalten Sie die gefüllte Spritze in der Hand und berühren Sie nicht die Spitze der Spritze.
- Legen Sie die gefüllte Spritze nicht ab, nachdem Sie sie vom Adapter gelöst haben.




SCHRITT 6: BEREITEN SIE DIE INJEKTIONSNADEL VOR

Für diesen Schritt benötigen Sie die Spritze mit der abgemessenen Nplate-Dosis sowie die Injektionsnadel mit Sicherheitssystem (Gegenstand D).

- Halten Sie die Spritze so in der Handfläche, dass die Spitze nach oben zeigt. **Entnehmen Sie die Injektionsnadel mit Sicherheitssystem aus der Verpackung.**

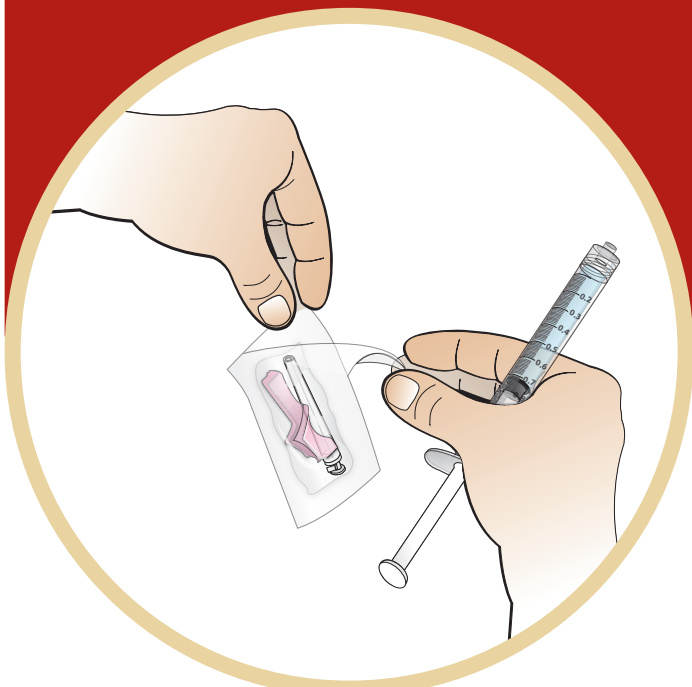


- Befestigen Sie die Injektionsnadel mit Sicherheitssystem an der gefüllten Spritze. Üben Sie starken Druck aus, während Sie drehen, um die Injektionsnadel mit Sicherheitssystem an der Spritze zu befestigen. Zum Einrasten in die Spritzenspitze **im Uhrzeigersinn drehen** (Luer-Lock-Verbindung).
- Das Arzneimittel ist jetzt fertig zur Injektion. Fahren Sie UNVERZÜGLICH mit Schritt 7 fort.

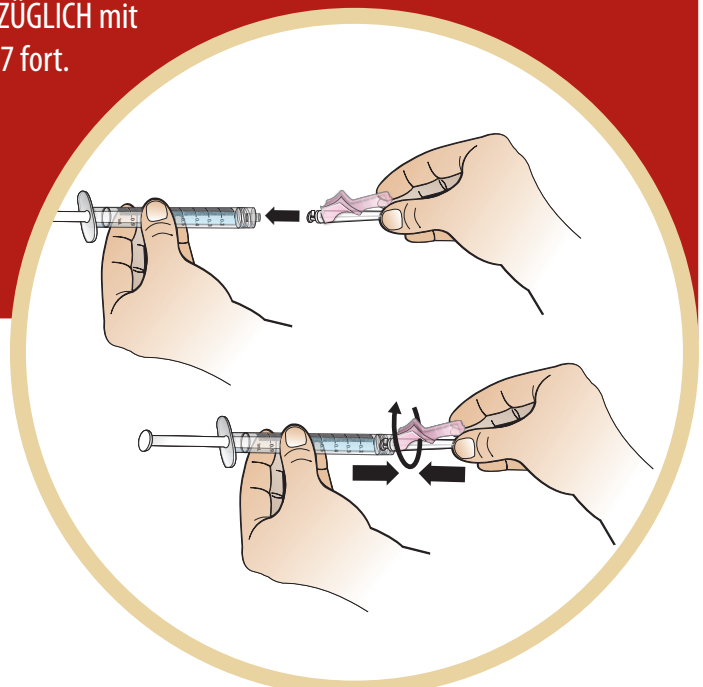


SCHRITT 7: WÄHLEN SIE EINE STELLE FÜR DIE INJEKTION AUS UND BEREITEN SIE DIESE VOR

Für diesen Schritt benötigen Sie einen neuen Alkoholtupfer (Gegenstand E).

- Wählen Sie Ihre Injektionsstelle aus. Die drei empfohlenen Injektionsstellen für Nplate sind:
 - Vorderseite des mittleren Bereiches der Oberschenkel,
 - Bauchraum, mit Ausnahme der 5 cm-Region rund um den Bauchnabel.
 - Wenn Ihnen eine andere Person die Injektion gibt, kann diese auch den äußeren Bereich der Oberarme benutzen.
 - Wechseln Sie die Stelle bei jeder Injektion.

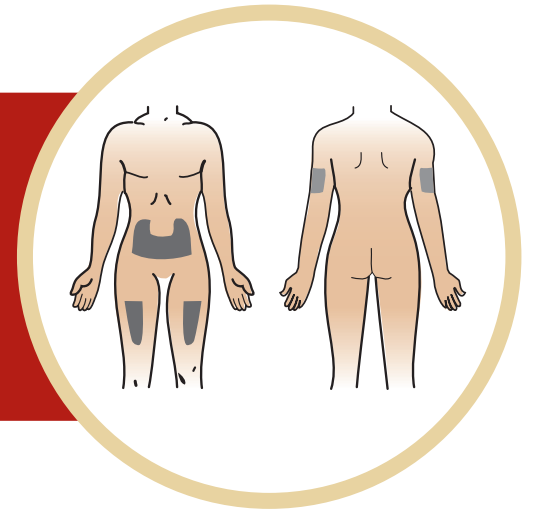


- Injizieren Sie nicht in Stellen, an denen die Haut empfindlich, geschwollen und hart ist.
- Injizieren Sie nicht in Stellen mit Narben oder Dehnungsstreifen.
- Wischen Sie mit einem Alkoholtupfer in einer kreisenden Bewegung über die Stelle, an der Nplate injiziert werden soll.
- Berühren Sie nicht erneut diese Stelle, bevor Sie die Injektion gegeben haben.

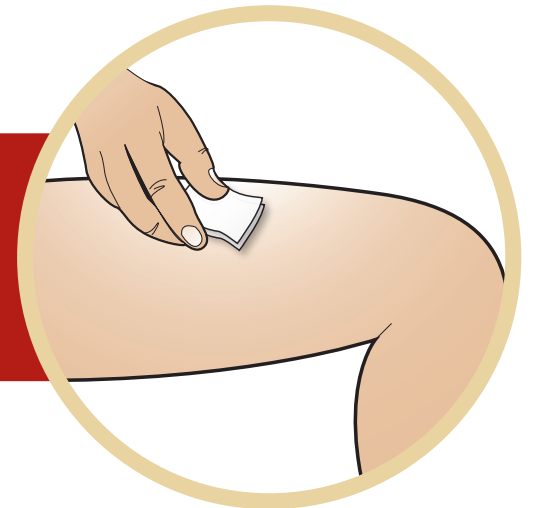


SCHRITT 8: INJIZIEREN SIE DIE NPLATE-FLÜSSIGKEIT

Für diesen Schritt benötigen Sie die gefüllte Spritze mit befestigter Injektionsnadel.

- Ziehen Sie die rosafarbene Schutzhülle zurück (in Richtung Spritze und weg von der Nadel).

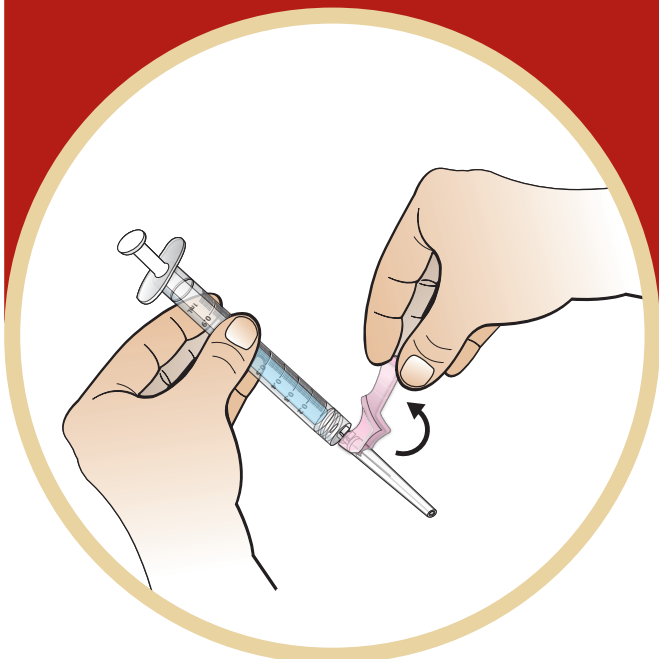


- Entfernen Sie den durchsichtigen Nadelschutz, indem Sie die Spritze in der einen Hand halten und den Nadelschutz vorsichtig mit der anderen Hand abziehen.
- Entfernen Sie den durchsichtigen Nadelschutz vor der Injektion.

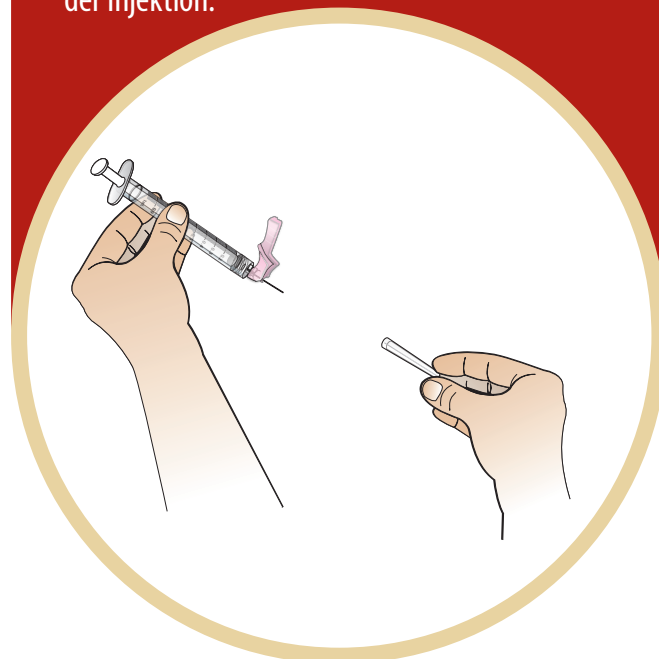

SCHRITT 8: INJIZIEREN SIE DIE NPLATE-FLÜSSIGKEIT

- Kneifen Sie mit der einen Hand behutsam die gereinigte Hautstelle zusammen und halten Sie diese fest. Halten Sie die Spritze mit der anderen Hand (wie einen Stift) in einem 45°-Winkel an die Haut.
- Stechen Sie die Nadel mit einer kurzen und schnellen Bewegung in die Haut.

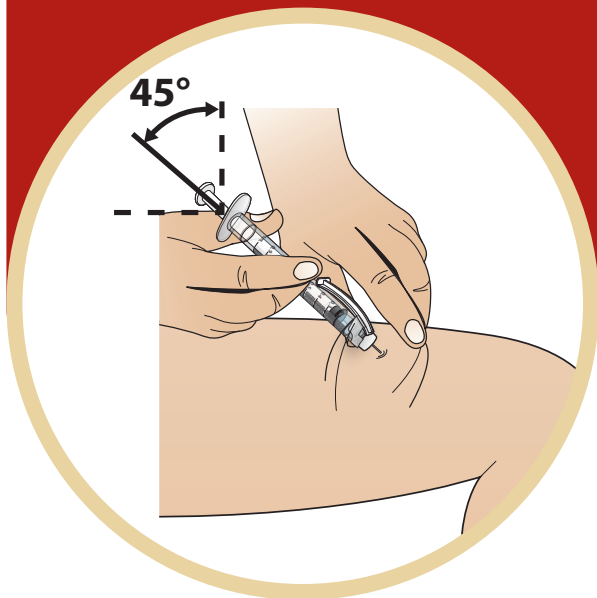


- Injizieren Sie die verschriebene Dosis unter die Haut entsprechend der Anleitung Ihres Arztes, des medizinischen Fachpersonals oder Apothekers.




- Sobald die Spritze leer ist, ziehen Sie die Nadel aus der Haut. **Achten Sie darauf, dass Sie dabei den gleichen Winkel wie bei der Injektion beibehalten.**
 - Es kann zu einer kleinen Blutung an der Injektionsstelle kommen. Sie können einen Wattebausch oder Verbandsmull für 10 Sekunden auf die Injektionsstelle drücken.
 - **Reiben Sie die Injektionsstelle nicht.** Falls notwendig, können Sie die Injektionsstelle mit einem Pflaster abdecken.

- **Benutzen Sie nach der Injektion Ihren Daumen (oder die Fingerspitze), um die rosafarbene Schutzhülle zu aktivieren,** indem Sie den Nadelschutz mit derselben Hand nach vorne drücken, bis Sie ein Klicken und Einrasten hören und/oder fühlen.

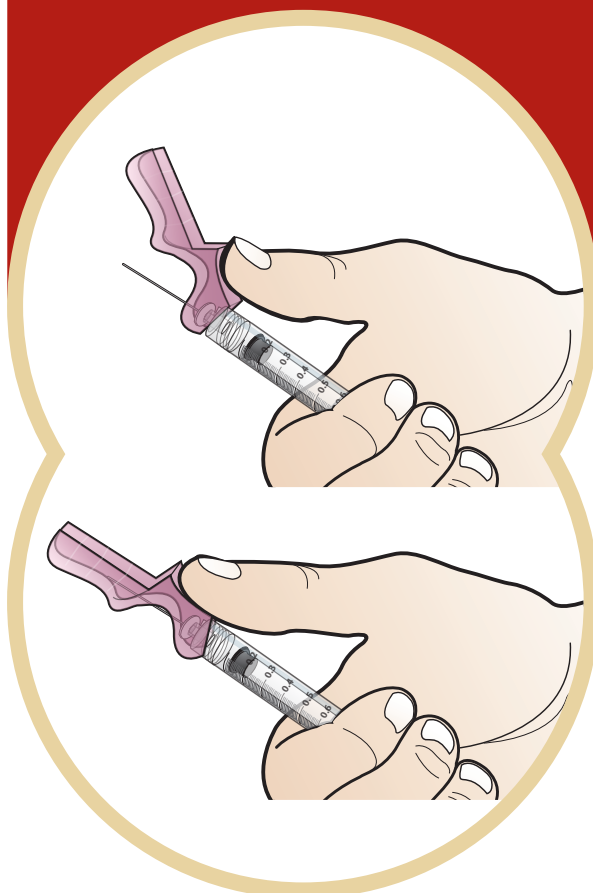

- **Überprüfen Sie visuell,** ob die Nadelspitze abgedeckt ist. Decken Sie die Nadel vor der Entsorgung immer mit der rosafarbenen Schutzhülle ab.

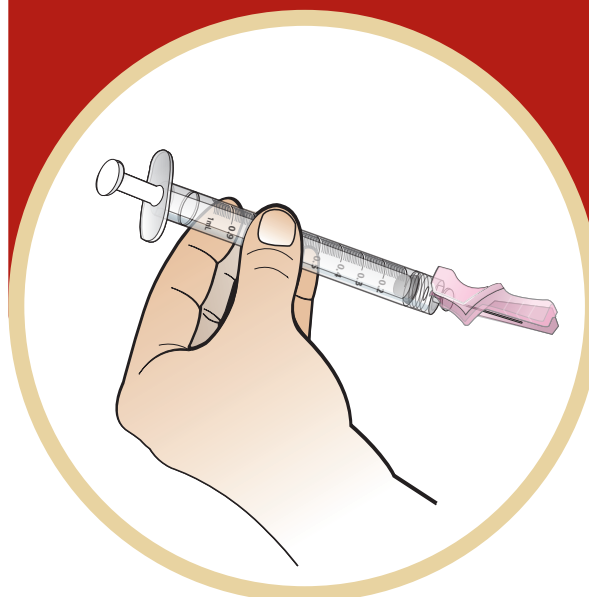

SCHRITT 9: ENTSORGEN SIE DIE MATERIALIEN

Gehen Sie wie folgt vor:

- Entsorgen Sie die mit der Schutzhülle abgedeckte Spritze sofort in einem Sicherheitsbehälter.
- Entsorgen Sie die benutzte Nplate-Durchstechflasche sofort in einem geeigneten Abfallbehälter.
- Stellen Sie sicher, dass alle anderen Materialien in geeigneten Behältnissen entsorgt werden.

Die Injektionseinheit und die Nplate-Durchstechflasche dürfen NIEMALS wiederverwendet werden.

- Entsorgen Sie die Nadel und die Spritze in einem durchstichsicheren Behältnis.
- Entsorgen Sie restliches Nplate in einem geeigneten Abfallbehälter.
In der Durchstechflasche verbliebenes Nplate darf NIEMALS für eine andere Injektion wiederverwendet werden.

WENN SIE MEHR NPLATE BENÖTIGEN, UM IHRE DOSIS ZU ERREICHEN ...

- Nehmen Sie ein neues Kit zur Selbstinjektion und eine neue Nplate-Durchstechflasche zur Hand.
- Gehen Sie zurück zum Anfang dieser *Schritt-für-Schritt-Anleitung* und wiederholen Sie die einzelnen Schritte der Vorbereitung und Anwendung des neuen Kits zur Selbstinjektion.



Meldung von Nebenwirkungen

Die Meldung von Nebenwirkungen ist von großer Wichtigkeit für eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von Arzneimitteln. Bitte melden Sie Nebenwirkungen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, <http://www.bfarm.de/> oder dem Zulassungsinhaber:

Amgen GmbH, Abteilung für Arzneimittelsicherheit
Riesstr. 24
80992 München
Tel.: 0800 - 26436 58
Fax: 0800 - 26436 51
E-Mail: eudemicalsafety@amgen.de



Alle Schulungsmaterialien für Patienten erhalten Sie über Ihren behandelnden Arzt.
Die Gebrauchsinformation ist online durch Scannen des QR-Codes oder über rm.amgen.de/nplate-rekonstitutionskit-gebrauchsinformation verfügbar.
Für gedruckte Exemplare und bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:
Medical Information von Amgen
MedInfo-Hotline 0800 - 26436 44, auf medinfo.amgen.de oder :
info@kohlpharma.com

